

Fichier No: 99697

Visite: 2014-10-01 01 Oct 14 10:28


Nicolet VikingQuest

VIASYS Healthcare NeuroCare

GUASCH,
1 Canal OG + OD 120 et 90 dB

PEA #1
Enregistrement 10:28:23

Pédale: Marche	Cad.: 11.4 Hz	Gauche : Click 90dB pSPL Alterné Droite: Bruit 60dB SPL	
Moyenne: Non	Set: 2	N: 500 R:	

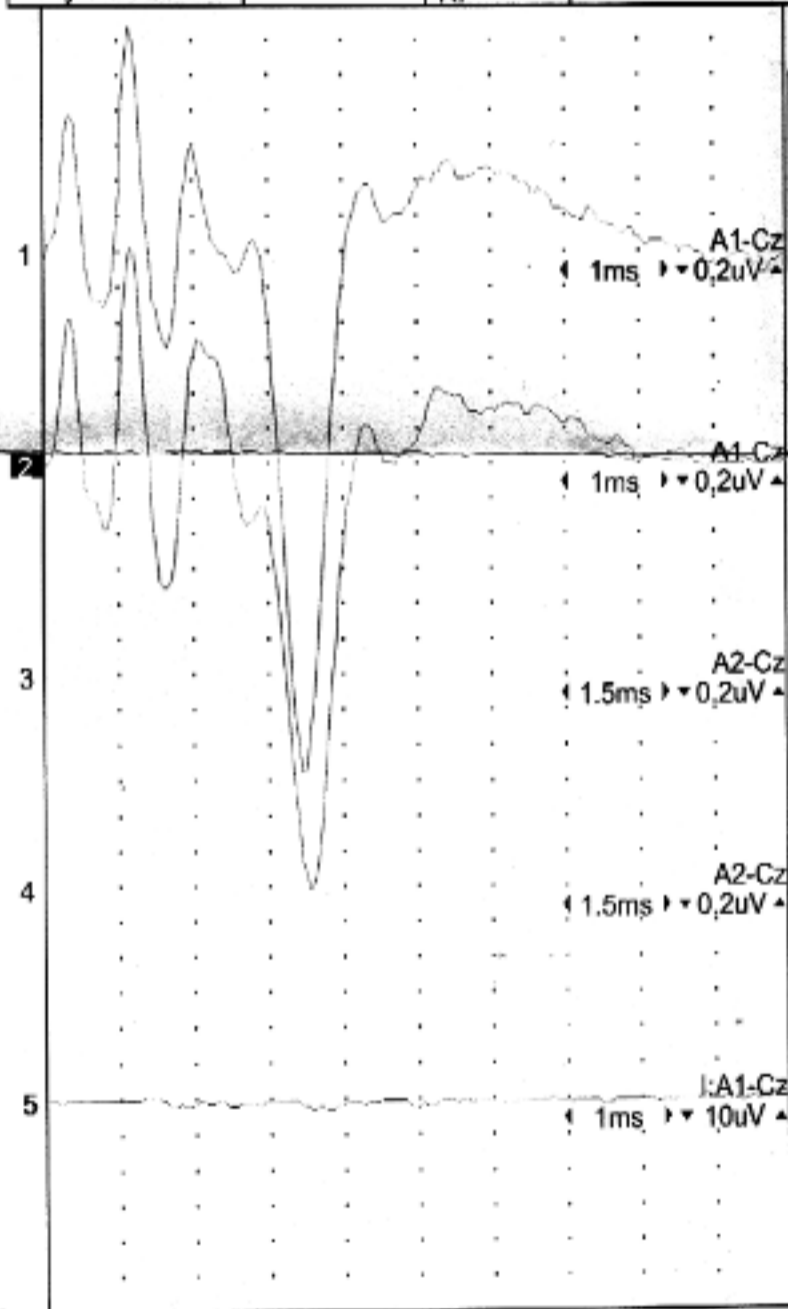

STIMULATION GAUCHE

Texte	Lat I ms	Lat II ms	Lat III ms	Lat IV ms	Lat V ms
G.120d	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
G.90dB	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1

STIMULATION DROITE

Texte	Lat I ms	Lat II ms	Lat III ms	Lat IV ms	Lat V ms
D.120d	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1
D.90dB	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1